

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución tampón de limpieza MK

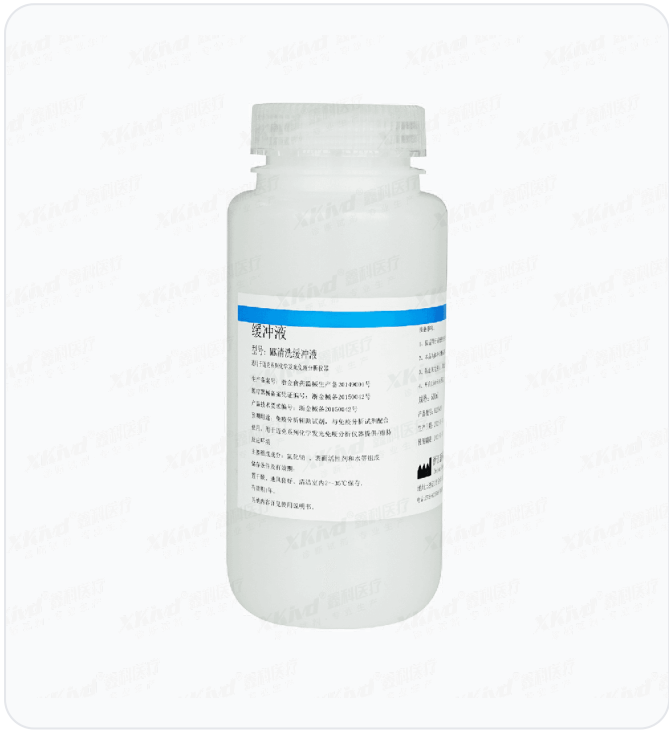


Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución tampón de limpieza MK
Código de Producto	p7

Dispositivos Compatibles

Maccura Maccura CLIA analyzers (series)

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.