

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução tampão de limpeza MK

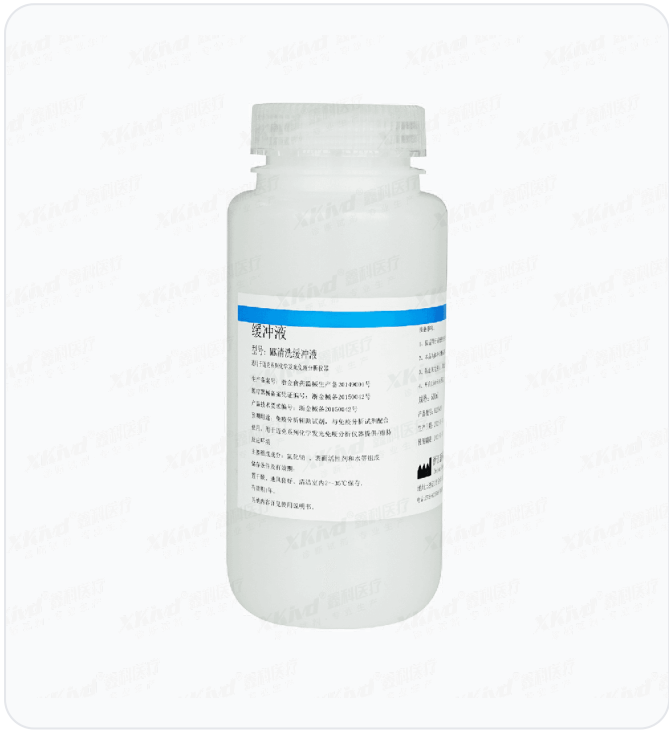


Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução tampão de limpeza MK
Código do Produto	p7

Dispositivos Compatíveis

Maccura Maccura CLIA analyzers (series)

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.